

РУКОВОДСТВО ПО ОЧИСТКЕ ЭНДОСКОПА EVIS EXERA III и более ранние модели (за исключением TJF-Q180V)

ВНИМАНИЕ! Данное описание порядка работы представляет собой краткий обзор этапов, которые необходимо выполнить для надлежащей обработки эндоскопов EVIS EXERA III. Выполняйте этапы согласно подробным указаниям в последней версии РУКОВОДСТВА ПО ОБРАБОТКЕ ЭНДОСКОПОВ.


Предварительная очистка в процедурном кабинете




Проверка герметичности



Ручная очистка

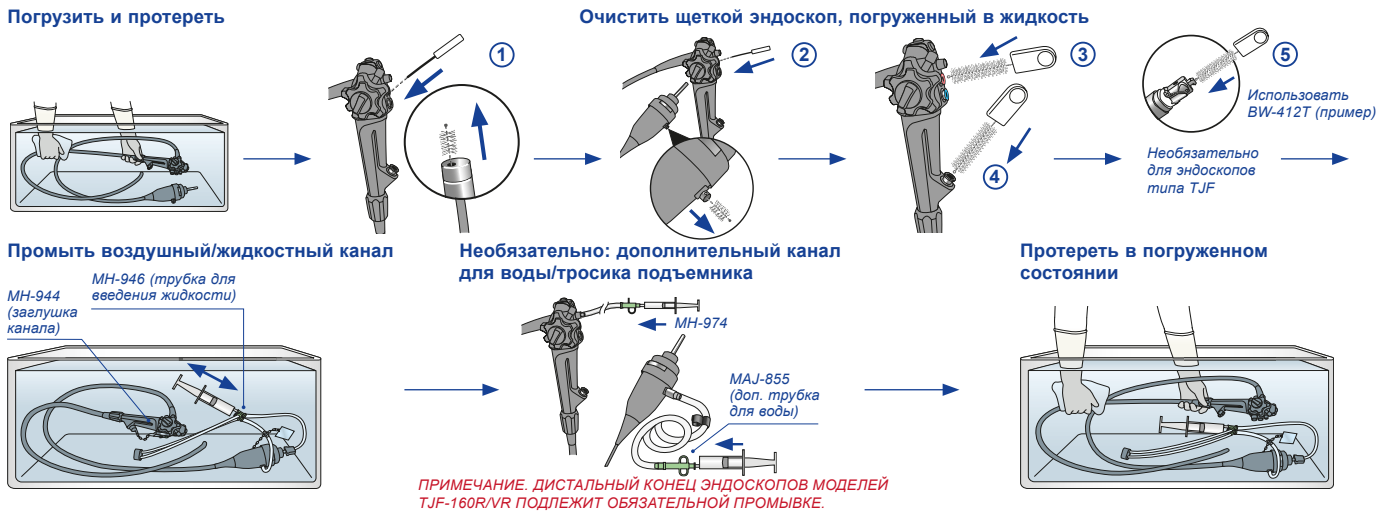

Промывка

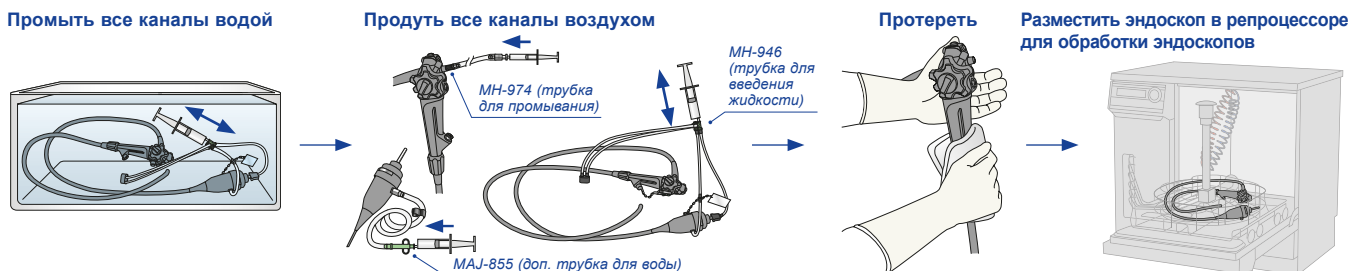

Данная информация не заменяет руководство по эксплуатации. Необходимо всегда обращаться к содержащимся там инструкциям.